


82481339_CntrTS_UG_RU_v1.indd ofc1

4/16/10 2:53:33 PM

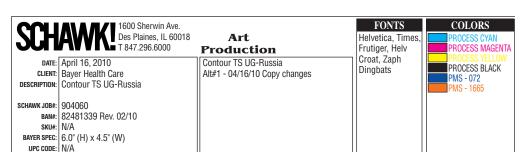

V-1 LANGUAGE

LANGUAGE(S): RUSSIAN

NOTE: THIS COLOR PROOF INDICATES COLOR BREAK ONLY AND MAY NOT ACCURATELY REFLECT ACTUAL PRODUCTION COLOR

24

(

Новый уровень точности и комфорта



Благодаря использованию современных технологий глюкометр *CONTOUR TS* [КОНТУР TC] обладает высокой точностью и прост в использовании. Мы рады тому, что помогаем Вам бороться с диабетом.



В отличие от многих других глюкометров, CONTOUR TS [КОНТУР TC] не требует ввода цифрового кода или установки кодированного чипа, поэтому его не нужно кодировать и на точность результатов не могут повлиять возможные ошибки ввода кода.

Содержание

I Ipubop CONTOUR IS [KOHTYP IC]	
Экран измерительного прибора CONTOUR TS [KOHTYP TC]	
Функции измерительного прибора	
Системная информация	
Симптомы при повышенном и пониженном	
уровнях глюкозы в крови	
Важная информация	
Подготовка к работе	
Подготовка скарификатора (устройства для прокалывания пальца)	1
Установка тест-полоски	1
Получение капли крови	1
Проведение исследования крови	1
Проведение исследования крови из других мест	1
Просмотр сохраненных результатов тестирования	1
Тест с использованием контрольного раствора	1

Установка даты, времени и звукового сигнала

Коды и символы ошибок

Замена батареи	28
Уход за системой	29
Передача результатов на компьютер	30
Характеристики	31
Используемые символы	32
Информация об обслуживании	33
Гарантия	34
Расходные материалы	36



Экран измерительного прибора Conтour TS [КонтуР TC]

Измерительный прибор CONTOUR TS [КОНТУР TC]:



ПРИМЕЧАНИЕ. Измерительный прибор CONTOUR TS [Контур TC] предназначен для использования только с тест-полосками CONTOUR TS [КОНТУР TC].

Экран измерительного прибора CONTOUR TS [KOHTYP TC]:

Отображение всех элементов экрана, как это показано на приведенном ниже рисунке, указывает на полную работоспособность экрана. Кратковременное отображение всех элементов выполняется при каждом включении измерительного прибора. Чтобы включить этот режим вручную, нажмите и удерживайте кнопку

при выключенном измерительном приборе. Сравните изображение на экране с приведенным ниже рисунком.

При отображении всех элементов необходимо убедиться в том, что символ $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ отображается полностью. Если это не так, см. раздел "Коды и символы ошибок" (стр. 27). Это может повлиять на отображаемые результаты.



Указывает на готовность прибора к тестированию.



Указывает на неподходящую для точного тестирования температуру.



Центральная область экрана для отображения результатов тестирования или кодов ошибок.



Указывает на то, что батарея разряжена и ее необходимо заменить.



Результаты отображаются в "mg/dL" (мг/дл) или "mmol/L" (ммоль/л).



Символ m / d или d • m указывает на формат даты.

Символ **РМ** или **РМ** указывает на

указывает на использование 12часового формата времени.

Δ

метка.

Среднее значение за 14 дней.

Контрольная



Индикатор устройства сигнализации (вкл./выкл.)

88/88 88:88

Нижняя часть экрана для отображения даты и времени.





Функции измерительного прибора

Новый прибор *CONTOUR TS [КОНТУР TC]* компании Bayer — это оптимальное сочетание простоты и высоких технологий

Система контроля уровня глюкозы в крови *Contour TS [Контур TC]* компании Bayer разработана таким образом, чтобы упростить измерение уровня глюкозы.

Основные характеристики



Прибор Контур ТС не требует кодирования, что делает его эксплуатацию гораздо проще и надежнее. Этот означает, что тест-полоски к Контуру ТС автоматически кодируют глюкометр,

поэтому Вам этого делать не надо. Этот прибор требует всего 0,6 мкл крови и позволяет получить точные результаты уже через 8 секунд. Существует также возможность взятия проб крови из разных мест — кончика пальца, ладони или предплечья.

Простота

Прибор CONTOUR TS [KOHTVP TC] прост как в освоении, так и в эксплуатации. Вся навигация осуществляется с помощью двух крупных кнопок, большой экран обеспечивает удобство считывания информации. Оранжевый порт для тест-полосок CONTOUR TS [KOHTVP TC] хорошо заметен, что делает установку тест-полосок более простой.

Удобство

Благодаря оптимальным размерам прибор *CONTOUR TS [КОНТУР TC]* очень удобно держать в руке. Он компактный и удобный для переноски. Прибор *CONTOUR TS [КОНТУР TC]* сочетает необходимую Вам точность и удобство в использовании.

Системная информация

Назначение

СОЛТОИЯ TS [КОНТУР ТС] (глюкометр, тест-полоски, контрольные растворы) - система для самоконтроля предназначена для людей с сахарным диабетом и врачам для того, чтобы отслеживать уровень сахара в крови у пациентов. Образцы капиллярной крови можно брать из альтернативных мест. В клинических условиях с помощью глюкометра CONTOUR TS [КОНТУР ТС] можно тестировать свежую венозную, артериальную цельную кровь.

! ВНИМАНИЕ

- Только для диагностики *в лабораторных условиях* **IVD**. Для наружного применения, не глотать тест-полоски.
- Потенциальная биологическая опасность: Медицинские работники, использующие данную систему с несколькими пациентами, должны иметь в виду, что все изделия и объекты, вступающие в контакт с человеческой кровью, даже после очистки должны рассматриваться как потенциально переносящие вирусные заболевания.
- Устройство для прокалывания MICROLET®2 с ланцетами для прокалывания, включенные в набор, не предназначены для использования медицинскими работниками. Не следует использовать ланцет более, чем одному человеку, чтобы избежать риска занесения инфекции.

Метод исследования: В системе CONTOUR TS [КОНТУР ТС] уровень глюкозы в крови определяется на основании измерения электрического тока, вызванного реакцией глюкозы с реагентами на электроде полоски. Кровь всасывается в заборный кончик тест-полоски за счет капиллярного эффекта. Содержащаяся в пробе глюкоза вступает в реакцию с FAD-глюкозо-дегидрогеназой (FAD-GDH) и феррицианидом калия. При отделении электронов возникает ток, пропорциональный уровню глюкозы в крови. Концентрация глюкозы в используемой пробе отображается на экране после завершения реакции. Никакие расчеты не требуются.





Важно

Системная информация

Ограничения.

- 1. Консерванты. Медицинские специалисты могут собрать пробы крови в пробирки с гепарином. Использование других антикоагулянтов или консервантов недопустимо.
- 2. Высота над уровнем моря. Высота в пределах 3048 м не оказывает существенного влияния на результаты.
- 3. Высокое содержание липидов в крови. Показания могут быть завышенными при концентрации холестерина >13,0 ммоль/л или при концентрации триглицеридов >33,9 ммоль/л.
- Растворы для перитонеального диализа. Интерференция между тест-полосками CONTOUR TS [КОНТУР ТС] и икодекстрином отсутствует.
- Ксилоза. Не выполняйте измерения во время проведения теста на абсорбцию ксилозы или сразу после него. Наличие ксилозы в крови приводит к интерференции.
- 6. Противопоказания. Измерение уровня глюкозы в капиллярной крови не назначается пациентам с ослабленным периферическим кровообращением. Причиной получения неверных результатов при измерении уровня глюкозы в периферической крови могут являться такие клинические факторы, как состояние шока, тяжелая форма гипотонии, гиперосмолярная гипергликемия и сильное обезвоживание.²
- 7. Интерференция. Снижение концентрации веществ, появляющихся в крови естественным образом (мочевая кислота, билирубин) или накапливающихся в ходе лечения (аскорбиновая кислота, ацетаминофен), не оказывает существенного влияния на результаты. Ограничивающие диапазоны концентраций этих компонентов приведены во вкладыше к тест-полоскам.

Глюкометр *CONTOUR TS (КОНТУР TC)* не предназначен для использования у новорожденных.

Функциональные характеристики

Согласно требованиям международного стандарта ISO 15197 отклонения 95% результатов тестирования при помощи глюкометров должны быть в пределах 20% лабораторных результатов, если полученный результат равен или выше 4,2 ммоль/л или в пределах 0,8 ммоль/л, если результат ниже 4,2 ммоль/л. Система СОNTOUR TS [КОНТУР ТС] показала лучшие результаты. Исследование проводилось при помощи 105 неподготовленных пользователей, больных диабетом, которые тестировали кровь из кончика пальца и смотрели, насколько показания прибора СОNTOUR TS [КОНТУР ТС] соответствуют лабораторным результатам. Исследование показало, что 97,9% результатов измерений СОNTOUR TS [КОНТУР ТС] соответствовали требованиям стандарта.

Симптомы при повышенном и пониженном уровнях глюкозы в крови:

Вы лучше оцените результаты тестирования, если будете знать о симптомах при повышенном и пониженном уровнях глюкозы в крови; это также поможет Вам решить, что Вы сделаете при наличии необычных результатов.

Далее перечислены наиболее частые симптомы:3

Высокий уровень сахара в крови (гипергликемия):

- частое мочеиспускание;
- чрезмерная жажда;
- затуманенное зрение;
- повышенная утомляемость;
- острое чувство голода;
- раздражительность.

Кетоновые тела (кетоацидоз) при отсутствии лечения гипергликемии:

- затруднение дыхания;
- тошнота и рвота;
- чрезмерная сухость во рту.

Низкий уровень сахара в крови (гипогликемия):

- дрожь:
- потливость;
- усиленное сердцебиение;
- затуманенное зрение;
- странное поведение;
- затруднение концентрации внимания:
- обмороки;
- судороги.

Если у Вас появился любой из этих симптомов, проверьте уровень глюкозы в крови. Если получен результат "LO" или "HI", немедленно обратитесь к лечащему врачу.

Дополнительную информацию и сведения о симптомах можно узнать у медицинского специалиста или на сайте www.bayerhealthcare.ru

www.bayerhealthcare.ru

Симптомы при повышенном и пониженном уровнях глюкозы в крови

Важно



Важная информация:

Работа прибора для измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR TS [КОНТУР ТС] основана на значениях плазмы/сыворотки крови. Методы, основанные на плазме/сыворотке, могут давать результаты на 9 – 15% выше по сравнению с методами оценки глюкозы по цельной крови.

- Всегда храните тест-полоски в оригинальном флаконе. Сразу после извлечения тест-полоски плотно закрывайте крышку. Флаконы специально предназначены для создания сухой среды для хранения тест-полосок. Если оставить флакон открытым или хранить тест-полоски не в ней нем, то они могут испортиться под воздействием влажности.
- Полностью высушите руки перед тем, как начать работу с тест-полосками или перед открыванием флакона.
- При формировании капли крови старайтесь не сжимать палец слишком сильно и проводите тест сразу же после формирования капли.
- НЕ капайте кровью прямо на ровную поверхность тест-полоски.
 Тест-полоска разработана таким образом, чтобы просто втягивать кровь через заборный кончик.
- НЕ прижимайте тест-полоску плотно к пальцу. Это может привести к ее закупориванию.
- НЕ используйте испорченные и/или использованные тестполоски. Тест-полоски предназначены только для одноразового использования.

Подготовка к работе:

- 1. Перед началом тестирования подготовьте все необходимые материалы. К ним относится глюкометр CONTOUR TS [КОНТУР ТС], тест-полоски CONTOUR TS [КОНТУР ТС] и скарификатор МИКРОЛЕТ 2 с ланцетами MICROLET [МИКРОЛЕТ]. Кроме того, может потребоваться контрольный раствор CONTOUR TS [КОНТУР ТС] для проверки работы прибора.
- Перед началом тестирования ознакомьтесь с руководством пользователя и всеми инструкциями, входящими в комплект измерительного прибора.
- 3. Измерительный прибор и тест-полоски должны некоторое время находиться в месте проведения тестирования для адаптации к температуре. Если измерительный прибор перемещается из одного места в другое, то перед началом тестирования измерительный прибор и тест-полоски должны находиться при новой температуре не менее 20 минут. Данный прибор позволяет получать точные результаты при температуре от 5°C до 45°C.
- 4. Важно не использовать тест-полоски или контрольные растворы после окончания срока годности, напечатанного на этикетке флакона и на картонной упаковке. Контрольный раствор CONTOUR TS (Контур ТС) не должен использоваться дольше шести месяцев с момента открытия флакона. Рекомендуется написать дату окончания срока годности контрольного раствора на этикетке флакона.
- 5. ВЫМОЙТЕ РУКИ ТЕПЛОЙ ВОДОЙ С МЫЛОМ И ВЫСУШИТЕ ИХ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ТЕСТИРОВАНИЯ.

↑ Потенциальная биологическая опасность

Медицинские работники или люди, использующие данную систему с несколькими пациентами, должны следовать правилам по инфекционному контролю, принятым в их учреждении. Все изделия и объекты, вступающие в контакт с человеческой кровью, даже после очистки должны рассматриваться как потенциально переносящие вирусные заболевания.¹



Важно

Подготовка к работе



Следующие действия (на стр. 10 – 14) необходимо выполнить в указанном порядке для проверки уровня глюкозы в крови.


Подготовка скарификатора: (устройства для прокалывания пальца)

Для получения инструкций ознакомьтесь с вкладышем для скарификатора Microlet2 [Микролет2]. Если Ваш скарификатор не соответствует изображенному на рисунке, следуйте руководству, поставляемому с Вашим устройством.


(СПОЛЬЗУЙТЕ НОВЫЙ ЛАНЦЕТ MICROLET [МИКРОЛЕТ] КАЖДЫЙ РАЗ ПРИ НОВОМ ТЕСТИРОВАНИИ, Т.К. ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ЛАНЦЕТ НЕСТЕРИЛЕН.

Вымойте и полностью высушите руки перед проведением тестирования.

Снимите наконечник скарификатора *MICROLET2* [*МИКРОЛЕТ2*].



Поверните (не снимайте) защитный колпачок ланцета на 1/4 оборота.



Вставьте ланцет в скарификатор до упора. Устройство будет поставлено на взвод.



Открутите колпачок ланцета.



Установка тест-полоски:

Выньте тест-полоску из флакона

Плотно закройте крышку флакона сразу после того, как вынули тест-полоску. Избыточная влага может испортить тест-полоску.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте срок годности и дату утилизации. Убедитесь, что тест-полоска не повреждена.

Держите тест-полоску серым концом вверх.

Вставьте серый конец в оранжевый порт для тест-полосок на измерительном приборе. Кодирование прибора не требуется!



Измерительный прибор включается. Отображается тест-полоска с мигающей каплей крови, указывающая на то, что измерительный прибор готов к тестированию. Не помещайте кровь на тест-полоску до тех пор, пока на экране не появится мигающий символ капли крови.



10

Для получения помощи воспользуйтесь бесплатным номером: 8 800 200 44 43; +7 495 775 16 50

www.bayerhealthcare.ru

11

Тестирование

Установка тест-полоски


Получение капли крови:

Выберите глубину прокола с помощью диска на **сером** наконечнике скарификатора *MICROLET2* [*МИКРОЛЕТ2*]: установите его на маленькую каплю для неглубокого прокола или на большую каплю для глубокого прокола. На глубину прокола также влияет давление, прикладываемое к месту прокола.


Плотно прижмите серый наконечник к месту прокола (обычно рекомендуется брать кровь из боковой части кончика пальца) и нажмите синюю кнопку спуска.



Подождите несколько секунд. С небольшим нажимом проведите рукой по пальцу в направлении места прокола для формирования капли крови. Не обхватывайте место прокола и не сжимайте слишком сильно свой палец.



Тест необходимо провести сразу же после формирования капли крови. (См. стр. 13.) Для теста достаточно объема 0,6 мкл.



На рисунке показан реальный размер необходимой капли крови

Информацию о взятии проб крови из других мест см. на стр. 15 и в инструкциях к скарификатору *Міспо*LET2 [МИКРОЛЕТ2].

Проведение исследования крови:

Держите Ваш прибор так, чтобы оранжевый порт для тест-полосок был направлен вниз или по направлению к себе. При таком положении прибор будет расположен правильно, чтобы проводить измерение глюкозы крови.

Сразу после формирования капли крови прикоснитесь к ней **заборным кончиком** тест-полоски. Через него кровь втягивается в тест-полоску.

Не прижимайте заборный кончик к коже и не капайте кровью на поверхность тест-полоски.


тобы полосок о положен измере-

Удерживайте заборный кончик тест-полоски в капле крови до тех пор, пока не прозвучит сигнал.

После сигнала на приборе начинается 8-секундный отсчет, по завершении которого на экране отображается результат тестирования. Удостоверьтесь, что оранжевый порт для тест-полосок направлен вниз или по направлению к Вам, когда Вы

Результат автоматически сохраняется в памяти прибора вместе с датой и временем тестирования.

смотрите результат тестирования.



www.bayerhealthcare.ru

12

13

Тестирование

Проведение исследования крови

Для получения помощи воспользуйтесь бесплатным номером: 8 800 200 44 43; +7 495 775 16 50



Ожидаемые значения: Уровень глюкозы в крови зависит от принимаемой пищи и лекарств, состояния здоровья, стрессового состояния или нагрузки. Чтобы узнать приемлемое для Вас значение, обратитесь к медицинскому специалисту. В соответствии с медицинской практикой для человека, страдающего диабетом, при отсутствии беременности стандартными считаются следующие значения:4

- Уровень глюкозы перед приемом пищи: от 5,0 ммоль/л до 7,2 ммоль/л
- Уровень глюкозы через 2 часа после приема пищи: менее 10,0 ммоль/л

№ ВНИМАНИЕ

- Если получен результат "НІ", уровень глюкозы в Вашей крови может быть выше 33,3 ммоль/л. Если получен результат "LO", уровень глюкозы в Вашей крови может быть ниже 0,6 ммоль/л. Повторите тест. Если результат не изменился, немедленно обратитесь к лечащему врачу или медицинскому специалисту.
- Не меняйте принимаемые лекарства на основании результатов, полученных с помощью измерительного прибора CONTOUR TS [КОНТУР ТС], без консультации с лечащим врачом или медицинским специалистом.

Для выключения прибора просто извлеките тест-полоску.

Потенциальная биологическая опасность: Утилизируйте тест-полоску, соблюдая необходимые меры предосторожности.



Измерительный прибор также выключается, если в течение трех минут с ним не выполняются никакие действия.

Утилизацию ланцета необходимо выполнять в соответствии с инструкциями к скарификатору MICROLET2 [МИКРОЛЕТ2].

Для получения помощи воспользуйтесь бесплатным номером: 8 800 200 44 43; +7 495 775 16 50

Проведение исследования крови из других мест

Пробы крови для проверки уровня глюкозы можно брать не только из кончиков пальцев. Ознакомьтесь с инструкциями к скарификатору.

Результаты тестирования крови, взятой из предплечья или ладони, могут значительно отличаться от результатов тестирования крови из кончика пальца. Эта разница появляется при быстром изменении уровня глюкозы, например после приема пищи, ввода инсулина или физической нагрузки.

Рекомендации:

1. Узнайте у медицинского специалиста, можно ли Вам брать пробы крови из других мест.



Ладонь



Предплечье

- 2. Если Вам предстоит выполнять ответственные действия, например управлять автомобилем или другой техникой, всегда берите пробу крови из пальца. Необходимо также брать кровь из пальца во время болезни, нервных расстройств или когда результаты измерений не соответствуют собственным ощущениям пациента
- 3. Не рекомендуется брать пробы крови из других мест, если Вы не можете распознать симптомы, сопутствующие снижению уровня глюкозы в крови. При низком уровне глюкозы в крови обратитесь к медицинскому специалисту.
- 4. При взятии проб крови из других мест выбирайте мягкие и мясистые участки тела без волос, родинок и видимых вен. Вымойте выбранное место с мылом в теплой воде, затем ополосните его и тщательно вытрите.
- 5. Берите пробы крови из других мест только не менее чем через 2 часа после:
 - приема пищи; приема лекарств; физических упражнений.

www.bayerhealthcare.ru




Тестирование

Просмотр сохраненных результатов тестирования:

При выключенном измерительном приборе нажмите и отпустите кнопку М для просмотра сохраненных результатов тестирований.

На экране отображается значение 14 day average (среднее за 14 дней), соответствующее среднему значению результатов тестов, выполненных за последние 14 дней.



Нажмите ♥ для просмотра результатов предыдущих тестов.

Результаты предыдущих тестов: Результаты тестов отображаются начиная с самого последнего. Для каждого результата отображается дата и время соответствующего тестирования.

Для прокрутки результатов можно нажать

▼. Нажмите и отпустите кнопку для просмотра результатов по одному или нажмите и удерживайте ее для быстрого перемещения по списку.

Отображение на экране символа **Год** указывает на то, что Вы просмотрели все хранящиеся в памяти результаты.

Измерительный прибор сохраняет в памяти 250 результатов тестирований. При заполнении памяти наиболее старые результаты перезаписываются более новыми.



Для выключения прибора нажмите М или просто не выполняйте с ним


никаких действий в течение трех минут.

Для получения помощи воспользуйтесь бесплатным номером: 8 800 200 44 43; +7 495 775 16 50

Тест с использованием контрольного раствора:

Контрольный раствор нужно использовать в следующих случаях:

- при первом использовании глюкометра
- для проверки точности показаний глюкометра
- при использовании новой упаковки тест-полосок
- в случае, если упаковка тест-полосок оставалась открытой продолжительный период времени
- в случае, если Вы не уверены в том, что ваш глюкометр работает должным образом
- Если полученные результаты тестирования не соответствуют Вашему самочувствию



Выньте тест-полоску из флакона

Плотно закройте крышку флакона сразу после того, как вынули тест-полоску. Избыточная влага может испортить тест-полоску.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте срок годности и дату утилизации контрольного раствора. Убедитесь, что тест-полоска не повреждена.

Держите тест-полоску серым концом вверх.

Вставьте серый конец в оранжевый порт для тест-полосок на измерительном приборе.

Измерительный прибор включается. Отображается тест-полоска с мигающей каплей крови, указывающая на то, что измерительный прибор готов к тестированию. Не помещайте контрольный раствор на тестполоску до тех пор, пока на экране не появится мигающий символ капли крови.





www.bayerhealthcare.ru



Тест с использованием контрольного раствора

Тестирование



82481339 CntrTS UG RU v1.indd 16-17

Гест с использованием контрольного раствора



Перед открытием немного встряхните флакон для перемешивания контрольного раствора.

Выдавите небольшую каплю контрольного раствора на чистую невпитывающую поверхность, например на лист вощеной бумаги.

Не капайте контрольным раствором на тест-полоску прямо из флакона.


Закройте флакон с контрольным раствором.

Сразу после формирования капли контрольного раствора прикоснитесь к ней заборным кончиком тест-полоски. Через него контрольный раствор втягивается в тест-полоску.

Удерживайте заборный кончик в капле до тех пор, пока не прозвучит сигнал.

После сигнала на приборе начинается 8-секундный отсчет, по завершении которого на экране отображается результат контрольного тестирования.







Измерительный прибор автоматически распознает и помечает (√) контрольный результат.

ПРИМЕЧАНИЕ: Символ √ не указывает на то, что результаты контрольного теста находятся в заданных пределах.

Сравните результаты контрольного теста со значениями "Normal Control Range" (нормальный контрольный диапазон), указанными на этикетке флакона или на нижней части упаковки с тест-полосками.

Верхнее и нижнее значения контрольного диапазона указаны на нижней части упаковки с тест-полосками.





Если результаты тестирования с помощью контрольного раствора выходят за пределы обозначенного диапазона, остановитесь. Не проводите самоконтроль до установления причин данной проблемы. Обратитесь к стр.27 и найдите соответствующие Коды Ошибок и таблицу Символов для устранения проблемы.

Для выключения прибора просто извлеките тест-полоску. Результат автоматически помечается и сохраняется в памяти измерительного прибора. Контрольные результаты не учитываются при расчете среднего значения уровня глюкозы за 14 дней.



www.bayerhealthcare.ru



19

Тест с использованием контрольного раствора

Тестирование

Для получения помощи воспользуйтесь бесплатным номером: 8 800 200 44 43; +7 495 775 16 50

(1)



Установка даты, времени и звукового сигнала:

На измерительном приборе можно настроить отображение различных параметров.

Чтобы перейти в режим настройки. нажмите кнопку М и удерживайте ее в течение трех секунд. Ненадолго отображаются все элементы экрана, а затем на экране отображается время.



ПРИМЕЧАНИЕ: В любое время во время настройки измерительный

прибор можно выключить, нажав и удерживая кнопку М.

Установка времени:

Мигает число в поле **hour** (Час). Нажимайте кнопку ▼ до тех пор, пока не отобразится правильное значение.

Нажмите кнопку М для установки значения.



Теперь мигает число в поле minute (Минуты). Нажимайте кнопку до тех пор, пока не отобразится правильное значение.

Нажмите кнопку М для установки значения.



После этого на экране отображается дата.

Мигает число в поле **year** (Год). Нажимайте кнопку ▼ до тех пор, пока не отобразится текущий год.

Установка даты:

Нажмите кнопку М для установки значения.



Теперь мигает значение month (Месяц). Нажимайте кнопку ▼ до тех пор, пока не отобразится текущий месяц.

Нажмите кнопку М для установки значения.



Теперь мигает значение day (День). Нажмите кнопку ▼ для выбора дня.

Нажмите кнопку М для установки значения.



Установка даты, времени и звукового сигнала

Настройка

20

Для получения помощи воспользуйтесь бесплатным номером: 8 800 200 44 43; +7 495 775 16 50

www.bayerhealthcare.ru



Настройка

22

Установка звукового сигнала:

После этого на экране отображается мигающий символ колокольчика.

Данный параметр определяет, подаются ли во время тестирования звуковые сигналы.

Нажмите кнопку ∇ , чтобы включить $\underline{\bullet}$ или отключить $\underline{\bullet}$ звуковые сигналы.

Нажмите кнопку **М** для установки значения.





Установка формата месяца и дня:

После этого на экране мигает параметр **d.m** (день.месяц).

Нажмите кнопку ▼ для выбора формата отображения даты: "месяц/день" (m/d) или "день.месяц" (d.m).

Нажмите кнопку **М** для установки значения.







После завершения настройки на экране отображаются все текущие значения параметров, после чего измерительный прибор автоматически отключается.




Установка 12- или 24-часового формата времени:

После этого на экране мигает параметр 24H (24-часовой). Нажмите кнопку ▼ для выбора значения "12H" (12-часовой) или "24H" (24-часовой).

Данный параметр позволяет задать формат отображения времени на измерительном приборе: 12-часовой с обозначениями "АМ" (До полудня) и "РМ" (После полудня) или 24-часовой.

Нажмите кнопку **М** для установки значения.





Установка даты, времени и звукового сигнала

Настройка

(

Для получения помощи воспользуйтесь бесплатным номером: 8 800 200 44 43; +7 495 775 16 50

www.bayerhealthcare.ru

Коды и символы ошибок:

ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	действия
	Батарея разряжена.	Как можно быстрее замените батарею (см. стр. 28).
	Недопустимая температура.	Перейдите в место, в котором температура соответствует рабочему диапазону прибора: 5°С – 45°С. Перед началом тестирования измерительный прибор и тест-полоски должны находиться при этой температуре не менее 20 минут.
	Заполнения тест-полоски недостаточно для точного тестирования.	Замените тест-полоску на новую и повторите тест.
	• Возможно, Вы несколько раз нанесли кровь на одну полоску.	 Не выполняйте несколько заборов крови с помощью одной и той же полоски.
	• Закупорен заборный кончик.	• Не прижимайте полоску к коже во время взятия пробы.
	• Капля крови слишком мала.	• См. информацию о рекомендуемом размере капли на стр. 12.
	Прибор обнаружил использованную тест-полоску.	Замените тест-полоску на новую и повторите тест. Перед взятием пробы крови дождитесь отображения на экране мигающей капли крови.

ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	ДЕЙСТВИЯ
	Тест-полоска вставлена неправильно.	Извлеките тест-полоску и вставьте ее правильно (см. стр. 11).
E5 E10 E6 E12 E8 E13 E9	Возможная ошибка программного обеспечения или оборудования.	Замените тест-полоску на новую и повторите тест. Если проблемы не устранены, обратитесь в службу поддержки клиентов.
	Неправильная тест-полоска.	Замените эту тест-полоску на тест-полоску <i>CONTOUR TS</i> [КОНТУР ТС] и повторите тест.
	• Во время обратного отсчета полоска была повреждена. • Полоска испортилась, так как долго находилась вне флакона. • Вставлена использованная тест-полоска.	Замените тест-полоску на новую и повторите тест. Тщательно следуйте инструкциям из руководства пользователя. Если проблемы не устранены, обратитесь в службу поддержки клиентов.







Ec

сли проблема не устранена, обратитесь в службу поддержки			
ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	ДЕЙСТВИЯ	
30. 10 12:08	Получен результат выше 33,3 ммоль/л.	Вымойте руки и место прокола. Повторите тест с использованием новой тестполоски. Если по-прежнему отображается результат "НІ", немедленно обратитесь к лечащему врачу или медицинскому специалисту.	
		ыше 13,9 ммоль/л может здоровья пациента.	
mmol	Получен результат ниже 0,6 ммоль/л.	• Повторите тест с использованием новой тест-полоски.	
30. 10 12:08		• Если по-прежнему отображается результат "LO", немедленно обратитесь к лечащему врачу или медицинскому специалисту.	

указывать на ухудшение состояния здоровья пациента.

JAGOSIDATO HA JAJAS		одоровынационна
После включения измерительного прибора экран гаснет.	• Измерительный прибор выключается, если в течение 3 минут с ним не выполняются никакие действия. Это позволяет увеличить время работы батареи.	• Попытайтесь включить прибор, нажимая кнопку М. Если экран гаснет менее, чем через 3 минуты, поменяйте батарейку.
	• Возможно, требуется замена батареи.	См. стр. 28.
Результаты отображаются в неправильных единицах измерения. ["mmoi/l" (ммоль/л) или "moi/dl" (мг/дл)].	Это может повлиять на отображаемые результаты.	Обратитесь в службу поддержки клиентов.

клиентов компании Bayer Diabetes Care по телефону 8 800 200 44 43; +7 495 775 16 50.

ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	ДЕЙСТВИЯ
При включении измерительного прибора отображаются не все элементы экрана.	Возможно, произошел сбой электроники измерительного прибора.	Нажмите и удерживайте кнопку
Недопустимый результат контрольного теста (слишком высокий или слишком низкий).	Тест-полоска испортилась под воздействием тепла или влаги. Истек срок годности контрольного раствора или срок хранения с момента открытия. Истек срок годности тест-полоски или срок хранения с момента открытия. Использован неправильный контрольный раствор. Температура контрольного раствора отличается от комнатной. Контрольный раствор недостаточно перемешан.	Повторите контрольное тестирование с использованием новой тестполоски. Проверьте сроки годности. Не используйте для тестирования материалы с истекшим сроком годности. Убедитесь, что используется контрольный раствор Сонтоия ТS [Контур ТС]. Подождите 20 минут для того, чтобы прибор достиг комнатной температуры. Повторите тест с контрольным раствором. Немного встряхните флакон для перемешивания контрольного раствора. Если результат все еще выходит за допустимые пределы, повторите тестирование с использованием новой тест-полоски и нового контрольного раствора. Если результат все еще выходит за допустимые пределы, обратитесь в службу поддержки.

www.bayerhealthcare.ru

27

Коды и символы ошибок

Устранение неполадок

Замена батарейки:

Замена батарейки требуется в том случае, если на экране постоянно отображается символ 🗓 или прибор не включается. Измерительный прибор CONTOUR TS [КОНТУР ТС] работает от одной 3-вольтовой литиевой батарейки (DL2032 или CR2032).



Надавите на крышку отсека батарейки и сдвиньте ее в направлении, указанном стрелкой.

ПРИМЕЧАНИЕ: После замены батарейки необходимо повторно выполнить настройку времени (см. стр. 20). Дату и другие параметры повторно настраивать не нужно. При замене батарейки сохраненные в памяти результаты не удаляются.



Для извлечения старой батарейки упритесь пальцем в верхнюю ее часть и потяните вверх. Возьмите батарейку и извлеките ее.

Поместите в отсек новую батарейку стороной со знаком "+" вверх (по направлению к Вам).

Задвиньте крышку отсека батарейки на место, выровняв ее по направляющим, и плотно закройте ее.



• Во избежание загрязнения маслом или другими веществами перед использованием прибора вымойте и вытрите руки. Если это возможно, храните измерительный прибор в

Уход за системой:

поставляемом вместе с ним футляре.

помощи при отравлении.

- Во избежание повреждения электроники или появления неисправностей обращаться с измерительным прибором следует очень аккуратно.
- Оберегайте тест-полоски и измерительный прибор от воздействия избыточной влажности, высоких и низких температур, пыли и грязи.

<u>Л</u> ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

правилами по защите окружающей среды.

Утилизируйте батарейки в соответствии с местными

Храните батарейки в недоступном для детей месте. Ли-

батарейку, немедленно обратитесь к врачу или в центр


тиевые батарейки содержат яд. Если Вы проглотили

Внешнюю часть измерительного прибора можно чистить с помощью куска влажной (не сырой) безворсовой ткани и слабого моющего средства или дезинфицирующего раствора, например 1 часть отбеливателя на 9 частей воды. После очистки прибор следует вытереть сухой безворсовой тканью.

✓! ВНИМАНИЕ: Следите за тем, чтобы раствор не попал внутрь корпуса через щели вокруг кнопок. Это может вызвать

неисправность.

Уход за системой



Передача результатов на компьютер:

Результаты тестирования можно передать с глюкометра CONTOUR TS [КОНТУР ТС] на компьютер, где из них можно сформировать отчет с графиками и таблицами. Для использования этой функции необходимо программное обеспечение по контролю диабета компании Bayer Diabetes Care и кабель для передачи данных Bayer.



/!\ ВНИМАНИЕ: Измерительный прибор CONTOUR TS [КОНТУР ТС] не тестировался и не сертифицирован компанией Bayer Diabetes Care для работы с каким-либо программным обеспечением, отличным от программного обеспечения по контролю диабета компании Bayer Diabetes Care. Компания Bayer Diabetes Care не несет ответственности за неверные результаты, полученные с помощью другого программного обеспечения.

Для получения дополнительной информации обратитесь в отдел службы поддержки клиентов (8 800 200 44 43, +7 495 775 16 50) или посетите наш интернет-сайт, расположенный по адресу www.bayerhealthcare.ru

Характеристики:

Тестируемый образец: цельная кровь

Результат теста: относительно значений глюкозы для плазмы/сыворотки

Объем образца: 0,6 мкл

Диапазон измерения: 0,6 – 33,3 ммоль/л

Время измерения: 8 секунд

Память: сохранение 250 последних результатов

Тип батареи: одна 3-вольтовая литиевая батарея батарейка (DL2032 или CR2032)

Срок службы батареи: приблизительно 1000 тестов (около 1 года эксплуатации)

Диапазон рабочих температур:

Влажность: 10 – 93% относительной влажности

Размеры: 71 мм (В) х 60 мм (Ш) х 19 мм (Т)

Вес: 56,7 г (2 унции)

Сигнал: звуковой сигнал подается при установке тест-полоски в измерительный прибор, при заполнении тест-полоски кровью или контрольным раствором и при отображении на экране результата теста. Два сигнала указывают на ошибку. Информацию об отключении звуковых сигналов см. раздел "Установка звукового сигнала" на стр. 22.

30 Для получения помощи воспользуйтесь бесплатным номером: 8 800 200 44 43; +7 495 775 16 50

www.bayerhealthcare.ru



Используемые символы:

На этикетках продуктов для системы контроля уровня глюкозы в крови *CONTOUR TS [КОНТУР TC]* (на этикетках и упаковках измерительного прибора, тест-полосок и контрольного раствора) используются следующие символы.



Используйте до указанной даты (до последнего дня месяца)



Код партии



Температурные ограничения



Следуйте инструкциям



Устройство для диагностики в лаборатории



Производитель



Внимание, см. сопроводительные документы



Кодовый номер продукта



Нижний контрольный диапазон



Нормальный контрольный диапазон



Верхний контрольный диапазон



Зеленая точка



Не использовать дважды



Батарейки должны быть утилизированы согласно требованиям, предъявленным в Вашей стране. За более подробными сведениями о соответствующих законах по уничтожению и утилизации отходов в Вашей стране, обращайтесь к местному Административному управлению.

Подлежащий уничтожению глюкометр должен расцениваться как фактор загрязнения среды и должен быть утилизирован согласно правилам безопасности в Вашей стране. Прибор не следует уничтожать вместе с другими электронными приборами.

32 Для получения помощи воспользуйтесь бесплатным номером: 8 800 200 44 43; +7 495 775 16 50

Информация об обслуживании:

При наличии проблемы, которую не удается устранить с помощью рекомендуемых в руководстве пользователя действий, обратитесь в службу поддержки клиентов компании Bayer, отдел Диабетической продукции. Бесплатный номер: 8 800 200 44 43 или + 7 495 775 16 50. Вам помогут квалифицированные специалисты.

Важно:

Прежде чем по какой-либо причине возвратить измерительный
прибор, обсудите это с представителем компании Bayer, отделом
Диабетической продукции. Он предоставит Вам информацию по
правильному и эффективному устранению проблемы.

🔲 Если Вы звоните в службу поддержки, держите под рукой прибор
измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR TS [ГЛЮКОМЕТР КОНТУР ТС]
и тест-полоски CONTOUR TS [ГЛЮКОМЕТР КОНТУР TC]. Также
рекомендуется иметь при себе флакон с контрольным раствором
CONTOUR TS [ГЛЮКОМЕТР КОНТУР TC] нормальной концентрации.

Перед обращением в службу поддержки заполните следующий
контрольный список!

Контрольный список

 Серийный номер (A) и номер модели измерительного прибора (B) (указаны на задней панели прибора):

Дата и время возникновения неисправности:



3.	Мною было прочитано руководство пользователя и предприняты
	следующие рекомендуемые в нем действия:

4.	Срок годности контрольного раствора CONTOUR TS [ГЛЮКОМЕТР КОНТУР ТС]
	и тест-полосок $CONTOUR\ TS\ [\ \Gamma\Pi HOKOMETP\ KOHTYP\ TC\]$ или срок хранения
	с момента открытия еще не истек:

20110110	60-00011110	требуется:	
замена	патапеи не	Thenvetca:	

www.bayerhealthcare.ru

Гарантия:

Гарантия производителя: Компания Вауег, отдел Диабетической продукции, гарантирует первоначальному покупателю, что данный прибор не будет иметь дефектов в материале и изготовлении в течение 5 лет со дня первоначальной покупки (кроме указанного ниже). Если в течение пятилетнего периода в приборе будут обнаружены дефекты, Компания Bayer, отдел Диабетической продукции, бесплатно заменит его на прибор той же или эквивалентной модели.

Ограничения гарантии: На данную гарантию распространяются следующие исключения и ограничения:

- 1. Продление 90-дневной гарантии осуществляется только для расходных материалов и/или аксессуаров.
- 2. Данная гарантия ограничена заменой по причине дефектов в материале или изготовлении. Компания Bayer, отдел Диабетической продукции, отказывается заменять оборудование, которое стало неисправным или было повреждено в результате злоупотребления, несчастных случаев, внесения модификаций, неправильной эксплуатации, небрежности, проведения техобслуживания человеком, не являющимся специалистом компании Bayer, отдела Диабетической продукции, или неправильного следования инструкциям. Кроме того, Компания Bayer, отказывается от любой ответственности за неисправности или повреждения оборудования компании Bayer, вызванные использованием реагентов, отличных от реагентов, произведенных или рекомендуемых компанией Bayer (например, тест-полосок CONTOUR TS [КОНТУР ТС]).
- 3. Компания Bayer, отдел Диабетической продукции оставляет за собой право вносить изменения в дизайн своего оборудования без обязательства внедрять эти изменения в ранее произведенное оборудование.
- 4. Компания Bayer, отдел Диабетической продукции, не обладает информацией об эффективности прибора измерения уровня глюкозы в крови CONTOUR TS [КОНТУР TC] при использовании любых тест-полосок, отличных от тест-полосок CONTOUR TS [КОНТУР ТС], и, следовательно, не дает никаких гарантий относительно работы измерительного прибора CONTOUR TS [КОНТУР TC] с любыми тестполосками, отличными от тест-полосок CONTOUR TS [КОНТУР ТС], или с тест-полосками CONTOUR TS [КОНТУР TC], в которые были внесены какие-либо изменения.

КОМПАНИЯ BAYER, ОТДЕЛ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ СРОЧНЫХ ГАРАНТИЙ НА ДАННЫЙ ПРОДУКТ. В СООТВЕТСТВИИ С ДАННОЙ ГАРАНТИЕЙ ЕДИНСТВЕННЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-СТВОМ КОМПАНИИ ВАУЕР, ОТДЕЛА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ ЗАМЕНА. УСЛОВИЯ КОТОРОЙ ОПИСАНЫ ВЫШЕ.

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ ВАУЕР, ОТДЕЛ ДИА-БЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ. НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРЯ-МЫЕ. ОСОБЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ. ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ BAYER, ОТДЕЛ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, БЫЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕ-НЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ.

Гарантийное обслуживание: Для получения информации об обслуживании покупатель должен обратиться в отдел службы поддержки клиентов компании Bayer, отдела Диабетической продукции, позвонив по телефону 8 800 200 44 43, +7 495 775 16 50, или зайти на сайт www.bayerhealthcare.ru

СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

¹Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline—Third Edition. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), document M29-A3, (ISBN 1-56238-567-4). CLSI, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, Pennsylvania 19087-1898, USA 2005.

²Atkin S., Jaker M.A., Chorost M.I., Reddy S.: Fingerstick Glucose Determination in Shock. Annals of Internal Medicine, 1991, 114: 1020-24.

- ³Американская диабетическая ассоциация, www.diabetes.org
- ⁴American Diabetes Association: Standards of Medical Care in Diabetes (Position Statement). Diabetes Care 29 (Suppl. 1):S10, 2006.

34 Для получения помощи воспользуйтесь бесплатным номером: 8 800 200 44 43; +7 495 775 16 50

www.bayerhealthcare.ru

82481339 CntrTS UG RU v1.indd 34-35

арантия



Расходные материалы:

При оформлении заказа на расходные материалы обязательно укажите номер и название детали или аксессуара.

ЗАМЕНЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Н	0	IV	16	ŗ)		
2	п	۵	n/	0	ш	1	2

элемента* Элемент

02521456 Одна 3-вольтовая (DL2032 или CR2032)

литиевая батарея батарейка

82481339 Руководство пользователя CONTOUR TS [КОНТУР ТС]

*Номера элементов могут быть изменены без уведомления



Bayer HealthCare

Выдано рег. уд. № ФСЗ 2007/00570 Байер Консьюмер Кеа АГ, Швейцария Ул.Питер-Мериан Штрассе 84, п/я 4052 Базель, Швейцария

Дополнительную информацию можно получить по адресу:
Отдел Диабетической продукции
3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2
107113 Москва, Россия
Тел. 8 800 200 44 43
+7 495 775 16 50
www.bayerhealthcare.ru



Bayer Consumer Care AG Postfach 4052 Basel, Switzerland



Логотип Bayer, the Bayer Cross, CONTOUR, *MICROLET* являются зарегистрированными торговыми марками Байера. «Без кодирования» - торговая марка Байера.

Bayer

36 Для получения помощи воспользуйтесь бесплатным номером: 8 800 200 44 43; +7 495 775 16 50

82481339

©2010 Bayer

Rev. 2/10

82481339_CntrTS_UG_RU_v1.indd 36-37